

Spasticitets- og dystoniklinik

Hvad findes på markedet?

Spasticitets- og dystoniklinik

- ”Jeg vil gerne....”

eller

- ” Vi vil gerne have, at....”

MTV

- ”En medicinsk teknologivurdering er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi.”...
- ...”at problemstillingen anskues ud fra en bred tilgang, som spænder over fire hovedområder: 1)teknologi/indsats 2)patient/borger, 3)organisation og 4) økonomi”

Mini-MTV

Mini-MTV (skema)

Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet

Skema og felter kan justeres og udvides alt efter behov.

Dato:

Spørgsmål 1 -3: Indledning

1: Hvem er forslagsstiller (sygehus, afdeling, person)?

2: Hvad er navn/betegnelse for den medicinske teknologi?

3: Hvilke parter er medinddraget i forslaget?

Spørgsmål 4 - 12: Teknologi

4: På hvilken indikation anvendes forslaget?

Hvad vil du have i medicinskabet ?




Medicinskab




- Lås
- Alarm
- Log-bog
- Indkøbssystem
- ”....der står en mand med et køleskab og en fryser hernede i receptionen.....hvor skal det stå?”

Ultralydsscanner

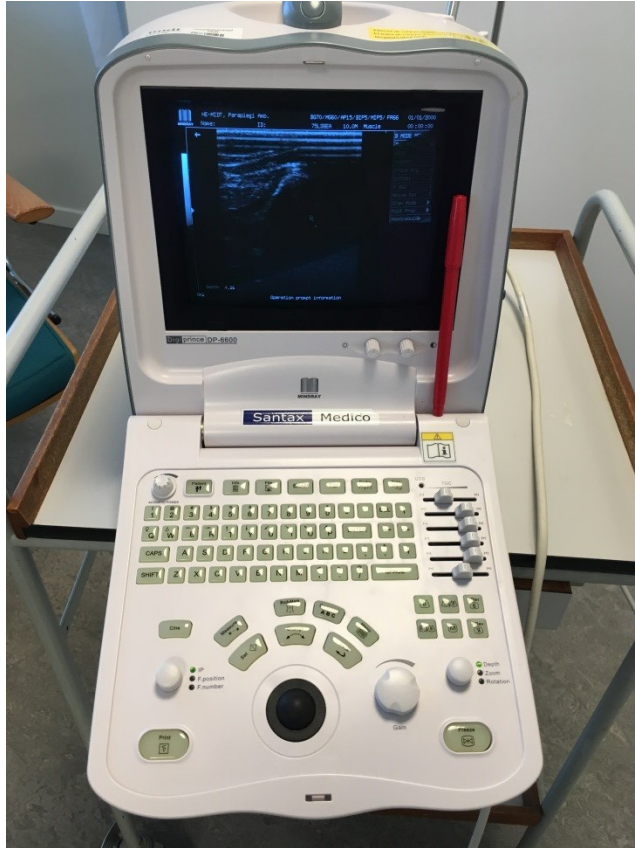


- Hvad skal jeg bruge UL-apparatet til?
- Hvilket apparat og hvilke tilvalg (prober mv.) er nødvendige for at jeg kan det?


Nåle: BO-SonoInject

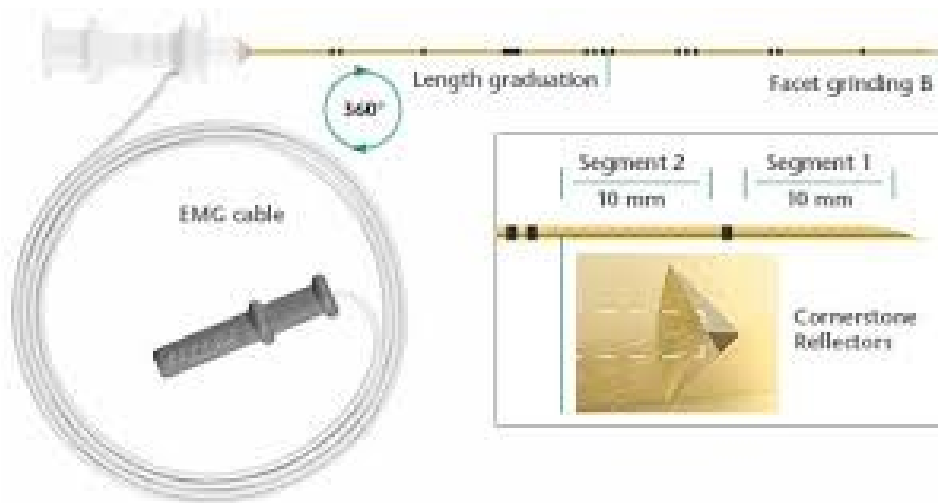


Nåle: Neuroline Inoject

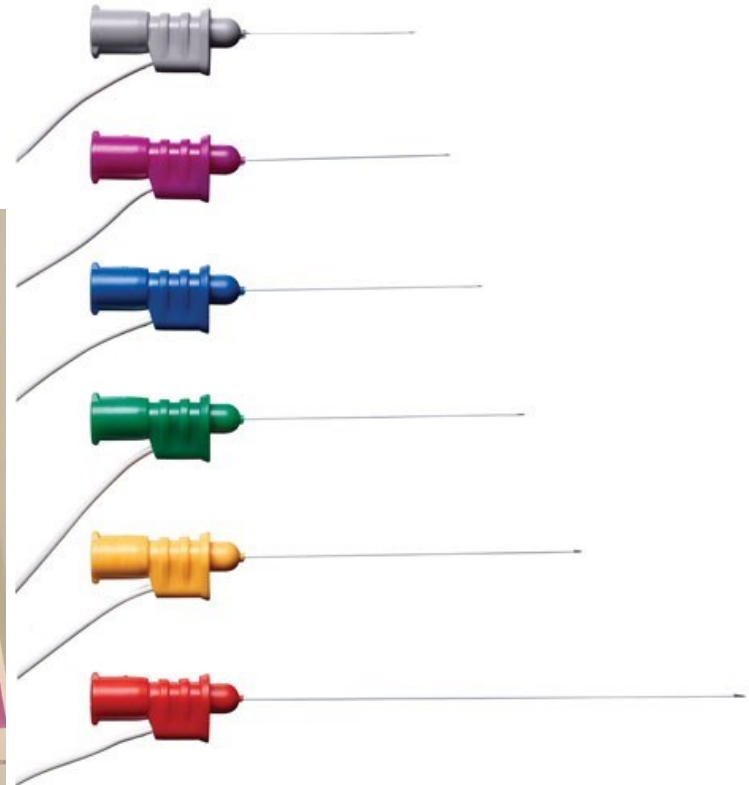

Nåle: Hybrid Needle Evolution

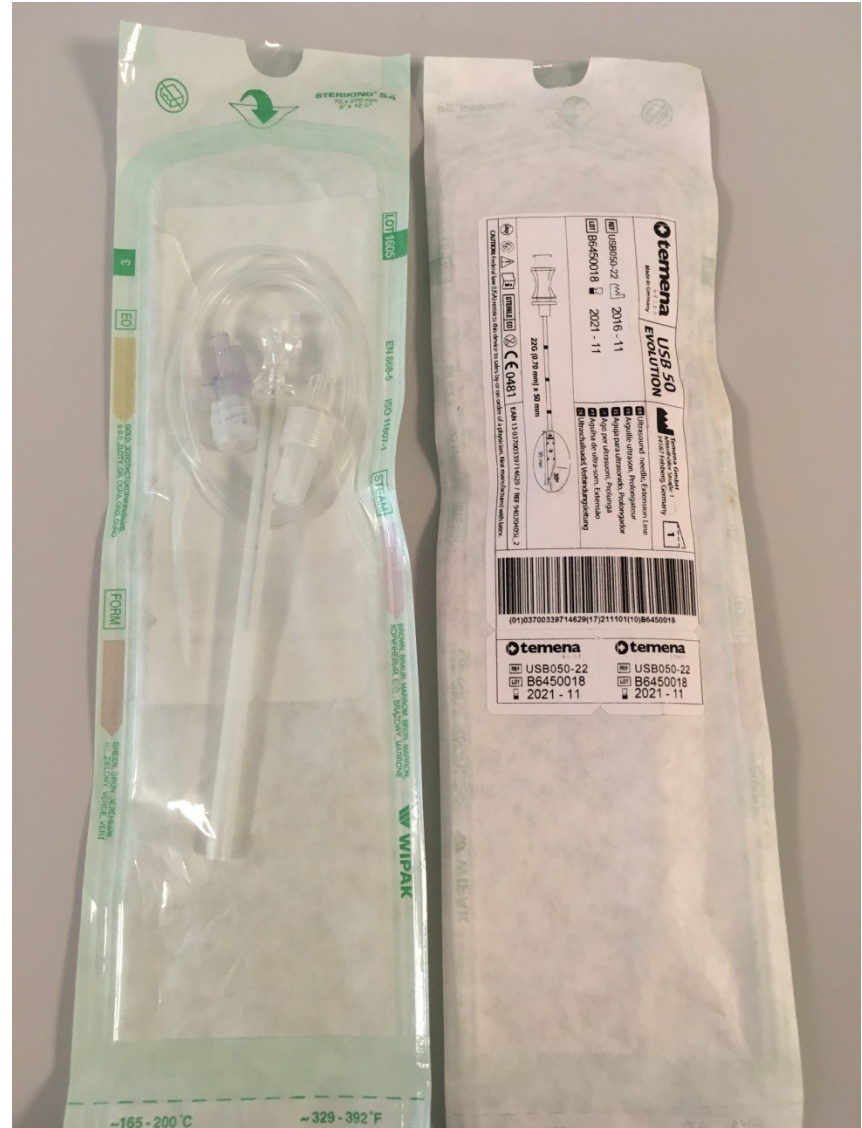

Nåle: BO-ject

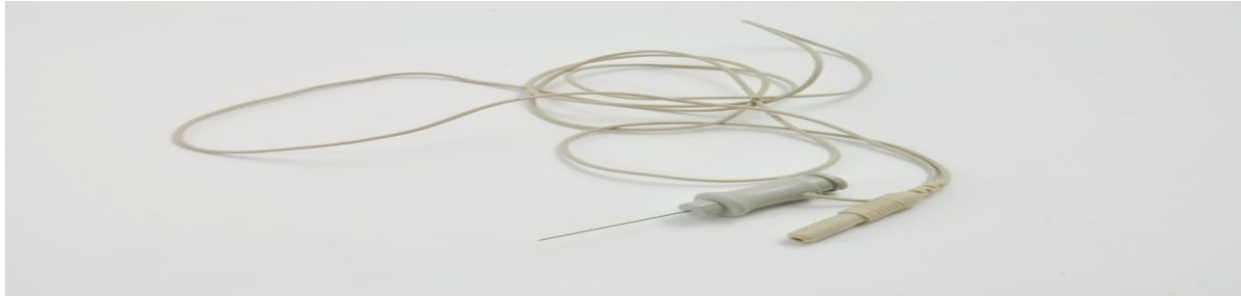

natus[®]
neurology

NatusNeuroStore

EMG

Myoguide



Se instruktionsvideo på
www.intronixtech.com/myoguide-training/

Clavis



EMG





SIZE - DEVICE:

- EMG and STIM functions in one compact device
- Easy to use & operate
- Battery powered
- Perfect match with Bo-ject needles

Disposable Bo-ject™ Needle Electrodes

Order #	Size	Cable Length	Instrument End
9013S0422	25 x 0.30 mm	90 cm	1.5 mm female TP
9013S0432	25 x 0.41 mm	90 cm	1.5 mm female TP
9013S0442	37 x 0.41 mm	90 cm	1.5 mm female TP
9013S0472	37 x 0.46 mm	90 cm	1.5 mm female TP
9013S0452	50 x 0.46 mm	90 cm	1.5 mm female TP
9013S0462	75 x 0.64 mm	90 cm	1.5 mm female TP

Each package contains 12 electrodes in individual pouches

PRE-GELLED SURFACE ELECTRODE FOR DIRECT CONNECTION

Order #	Size	Cable Length	Instrument End
9013L0453	9 x 6 mm	50 cm	1.5 mm female TP

Each package contains 12 electrodes

TAB ELECTRODE - TO BE USED WITH CONNECTION CABLE

Order #	Size	Cable Length	Instrument End
9013S0232	10 x 10 mm	n/a	n/a

Each package contains 100 electrodes

CONNECTION CABLE FOR TAB ELECTRODES

Order #	Color	Cable Length	Instrument End
9013P0602	Green	80 cm	1.5 mm female TP
9013P0642	Red	80 cm	1.5 mm female TP

Each package contains 2 cables

Elektroder



Elektroder



Steril ultralydsgel



Ikke steril ultralydsgel



Desinfektion/rengøring

Patienten



UL-apparat m.v




Arbejdsstilling



Arbejdsstillinger



Atlas, doser mm.

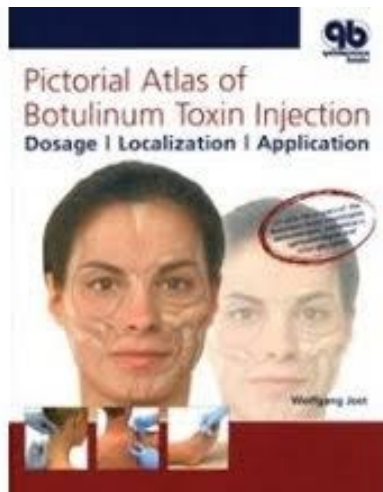

Andet

-
- Skr. informationsmateriale til pt.
- Behandlingsdagbøger
- Vurderingsskemaer
- Patienttilfredshed
- ”Man bliver spurgt om de mest underlige ting”